Produit

BLAYCO®

Câble-pince réutilisable pour plaques électrochirurgicales.

Références

4200 : TCC00 (3m), TCCA1 (5m).
4210 : TCC10 (3m).
4212 : TCC12 (3m), TCCA2 (5m).

Date

Février 2021

N. Spécification

ETP/141/9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux

- Câble :
  cuivre avec PVC.
- Pince :
  ABS.
- Connecteur :
  - Borne interne : laiton argenté.
  - Molde connecteur : 4200 : PVC + PP.
    4210 : PVC.
    4212 : PVC.
  - Pin (4212) : Acier inoxydable

Principales propriétés dimensionnelles

Référence	*Connecteur*	*Pince*	*Câble*	*Largueur*
TCC00	Mâle Larg.: 31 ± 1mm Ø: 6.3 ± 0.1mm	31 x 54 mm Largeur borne 7.5 ± 0.1mm	3.2 ± 0.05mm x 6.1 ± 0.1mm	300 ± 10cm
TCCA1				520 ± 20cm
TCC10	Femelle Prof: 12±0.5mm Ø: 2.30 ±0.05mm	31 x 54 mm Largeur borne 7.5 ± 0.1mm	3.2 ± 0.05mm x 6.1 ± 0.1mm	300 ± 10cm
TCC12	Femelle Prof: 12±0.5mm Ø: 2.30 ±0.05mm Pin : Long: 9.7±0.5mm Ø: 2.0±0.05mm	31 x 54 mm Largeur borne 7.5 ± 0.1mm	3.2 ± 0.05mm x 6.1 ± 0.1mm	300 ± 10cm
TCCA2				520 ± 20cm

Ce document est propriété de Telic, S.A.U., en conséquence la transmission à un tiers ou les copies non-autorisées sont interdites.

Schème du produit

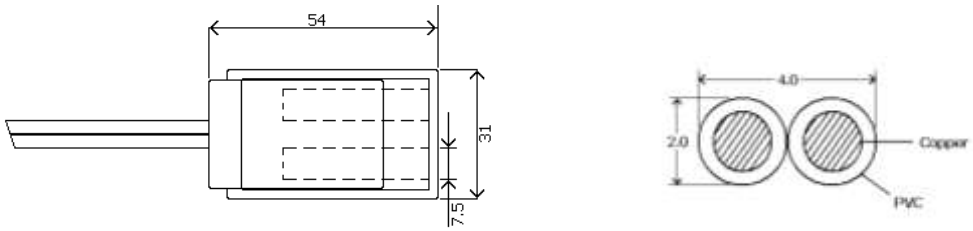

REF. 4200

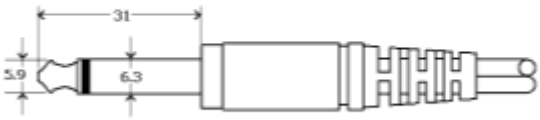

REF. 4210

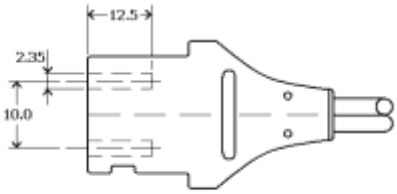

REF. 4212

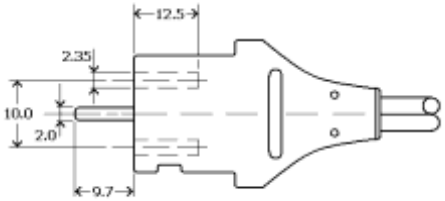

Propriétés physiques et électriques

- Résistance au test de voltage 2100V, 5min.
- Résistance à la traction câble – pince: ≥ 4kg.
- Résistance à la traction connecteur – câble : ≥ 4kg.
- Resistance subjection pince – plaque : > 7kg.

Réquisits légales et Standards

- Répond aux requisits RoHS.
- Courant de fuite de haute fréquence (IEC 60601-2-2, cl. 59.103.5) : ok
- Rigidité diélectrique de haute fréquence (IEC 60601-2-2, cl. 59.103.6) : ok
- Rigidité diélectrique de haute fréquence du réseau (IEC 60601-2-2, cl. 59.103.7) : ok
- Résistance jonction câble – connecteur (IEC 60601-2-2, cl. 56.102) : ok

Ce document est propriété de Telic, S.A.U., en conséquence la transmission à un tiers ou les copies non-autorisées sont interdites.

Stérilisation et date de péremption

- Produit non stérile.
- Péremption : 5 ans après de la date de fabrication.

Conservation et maintenance

- Conserver à l'abri du rayonnement du soleil / la intempérie.
- Conserver dans un endroit sec.
- Produit réutilisable. La seule maintenance nécessaire pour ce produit est de le nettoyer avant de le réutiliser.
- PROCÉDURE DE NETTOYAGE
  Nettoyer avec une brosse ou une éponge imbibée d'une solution d'alcool ou d'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Eviter le contact entre les fluides et le connecteur. Rincer avec de l'eau et du savon ou avec de l'eau distillée ou dé ionisée. S'assurer que la pince et le câble sont parfaitement secs après le lavage.

Conditionnement

- Sachet minigrip individuelle avec instructions d'utilisation.

MODE D'EMPLOI

- Inspecter la pince, le câble et le connecteur avant de les u□liser. Vérifier qu'il n'existe pas des coupures ou des traces de corrosion.
- Placer la plaque au pa□ent selon les instruc□ons.
- Situer la pince de fixa□on en posi□on ouverte et insérer la langue□e de la plaque entre les mâchoires de la pince, afin qu'elle reste bien centrée.
- Situer la pince en posi□on de fermée.
- Vérifier le bon fonc□onnement du circuit d'alarme de l'appareil électro chirurgical, misant en place de l'appareil avant de lui brancher le câble. Vérifier que l'alarme ne répond plus lorsque vous branchez le câble. Si l'alarme ne cesse pas, vérifier l'état du contact plaque-pa□ent, câble, connexions et générateur.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises de la **Directive 93/42/EEC** et qu'il est fabriqué, selon la normative du Système de Qualité certifié comme **ISO 13485**.

Ce produit se classifie comme :

- Produit de **Classe I** selon l'Annexe IX du Directive 93/42/EEC, règle 1.
- Code GMDN: 47487 Câble de connexion exclusivement électrique pour dispositif médical, réutilisable.

Ce document est propriété de Telic, S.A.U., en conséquence la transmission à un tiers ou les copies non-autorisées sont interdites.